


**LAPORAN HASIL UJI NURSING BED**

Tanggal Pengujian : 19 November 2018  
 Jenis Pengujian : Pengujian Kestabilan Statis  
 Type : CB 7011 D  
 Jumlah Sampel : 1 unit

Ilustrasi Cara Pengujian :

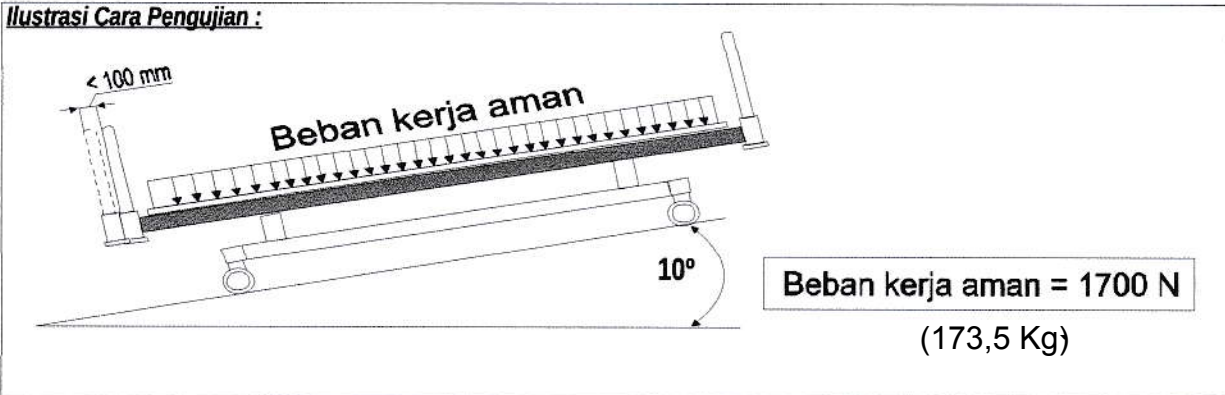

Metode Pengujian ( JIS T9205 : 2009 10.3d )

1. Bed diletakkan pada permukaan miring dengan sudut kemiringan 10° dengan kondisi caster terkunci
2. Bed diberi beban sebesar 1700 N (beban kerja aman)

No	Kriteria Pengujian	Standar	Hasil Uji	Keterangan
1	Diberi beban sebesar 1700 N <b>(173,5 kg)</b>	Bed harus stabil (tidak bergerak >100 mm)	OK	

**KEPUTUSAN :**

OK                      ~~NG~~

Cimahi, 19 November 2018  
Dilaporkan dan diuji oleh

Stefanus Bambang R.  
 QC Testing

Mengetahui  
 Widadi  
 CO of QC