


LAPORAN HASIL UJI NURSING BED

Tanggal Pengujian : 02 Mei 2017  
 Jenis Pengujian : Pengujian beban Statis  
 Type : CB 135 D-ST  
 Jumlah Sampel : 1 unit

Ilustrasi Cara Pengujian :

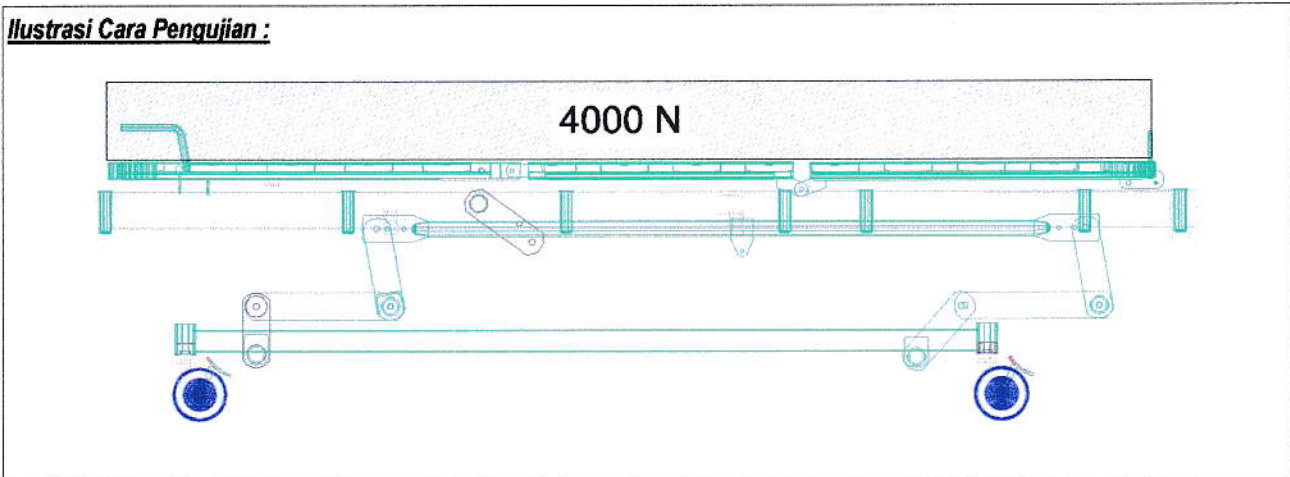

Metode Pengujian ( JIS T9205 : 2009 10.2 )


1. Bed diletakkan pada permukaan yang rata (posisi 0°)
2. Beban seberat 4000 N diletakkan di atas bed selama 1 jam ( beban dibagi menjadi 3 Bagian ; 45% bagian punggung, 25% bagian tengah, dan 30% bagian kaki)

No	Kriteria Pengujian	Standar	Hasil Uji	Keterangan
1	Setelah beban diturunkan	Tidak terjadi perubahan/kelainan pada bagian-bagian Bed	OK	
		Semua komponen berfungsi dengan normal	OK	


**KEPUTUSAN :**

<b>OK</b>	<del><b>NG</b></del>
-----------	----------------------

Cimahi, 02 Mei 2017  
 Dilaporkan dan diuji oleh

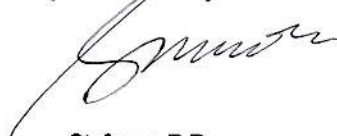  
 Stefanus B.R.  
 QC Testing


Mengetahui

  
 Widadi  
 CO of QC

LAPORAN HASIL UJI NURSING BED

Tanggal Pengujian : 03 Mei 2017  
Jenis Pengujian : Pengujian Stabilitas Bed Arah lebar  
Type : CB 135 D-ST  
Jumlah Sampel : 1 unit

Ilustrasi Cara Pengujian :

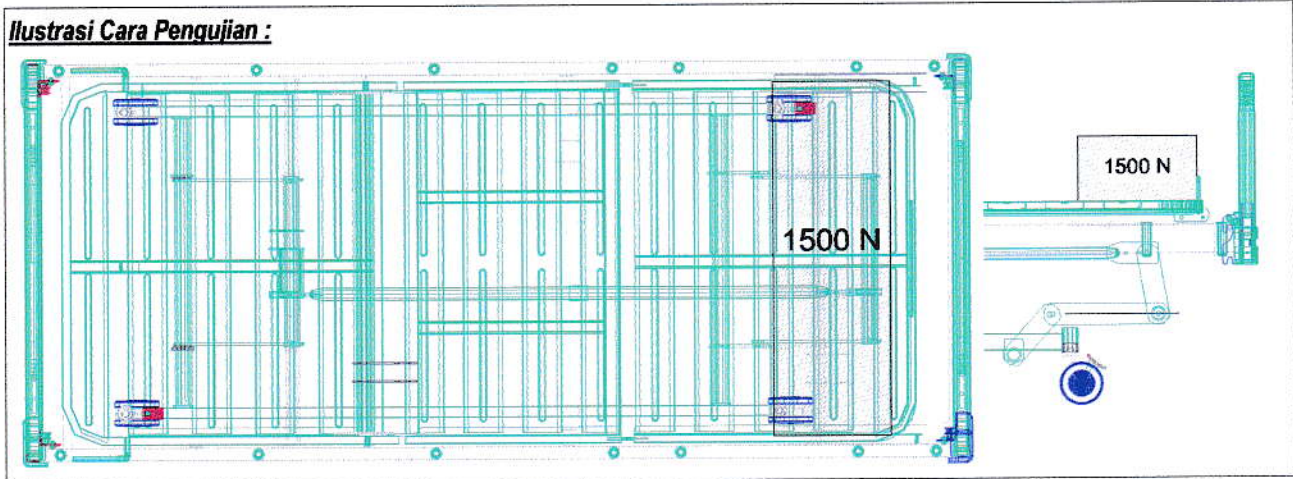

Metode Pengujian ( JIS T9205 : 2009 10.3b )

1. Bed diletakkan pada permukaan yang rata (posisi 0°)
2. Beban seberat 1500 N pada posisi pinggir bed, sepanjang bed dengan lebar 250mm  
( Lihat ilustrasi pengujian )

No	Kriteria Pengujian	Standar	Hasil Uji	Keterangan
1	Diberi beban sebesar 1500 N	Bed harus stabil ( tidak terguling )	OK	

**KEPUTUSAN :**

OK                      ~~NG~~

Cimahi, 03 Mei 2017  
Dilaporkan dan diuji oleh

Stefanus B.R.  
QC Testing


Mengetahui

Widadi  
CO of QC

LAPORAN HASIL UJI NURSING BED

Tanggal Pengujian : 09 Mei 2017  
Jenis Pengujian : Pengujian Stabilitas Bed Arah menyamping  
Type : CB 135 D-ST  
Jumlah Sampel : 1 unit

Ilustrasi Cara Pengujian :

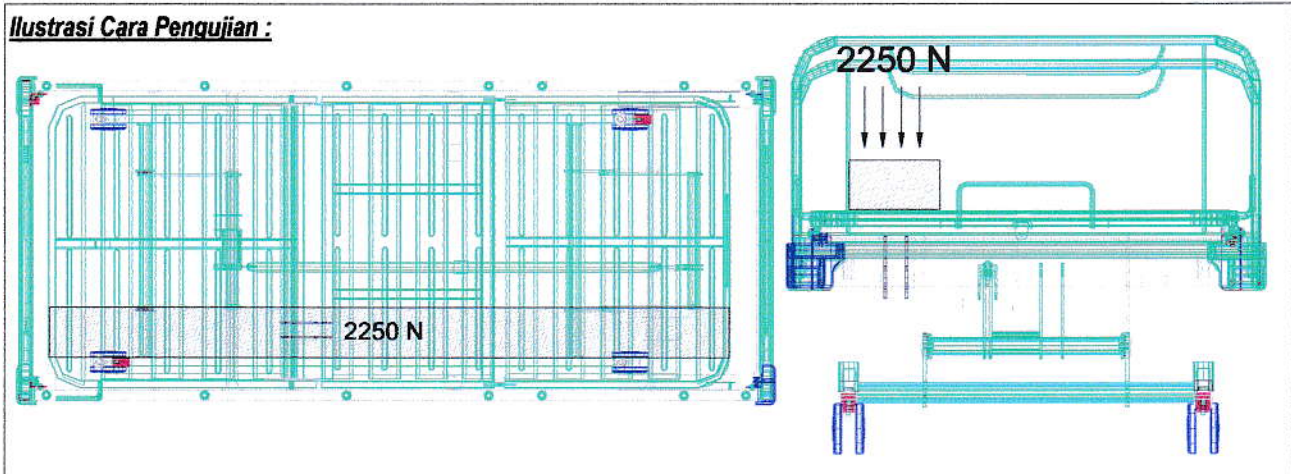

Metode Pengujian ( JIS T9205 : 2009 10.3a )

1. Bed diletakkan pada permukaan yang rata (posisi 0°)
2. Beban seberat 2250 N pada posisi pinggir bed, sepanjang bed dengan lebar 250mm  
( Lihat ilustrasi pengujian )

No	Kriteria Pengujian	Standar	Hasil Uji	Keterangan
1	Diberi beban sebesar 2250 N	Bed harus stabil ( tidak terguling )	OK	

**KEPUTUSAN :**

OK                      — NG —

Cimahi, 10 Mei 2017  
Dilaporkan dan diuji oleh

Stefanus B.R.  
QC Testing

Mengetahui

Widadi  
CO of QC