
	LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK PUSAT STANDARDISASI DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN R.I.	 LSPPr-004-IDN
	SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI	
BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH		

Nomor : 570.2 / Bd / BBBBT-3 / III / 2011

Pada hari ini kamis tanggal 3 bulan Maret tahun 2011,
 yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai Petugas Pengambil Contoh, berdasarkan Surat
 Tugas Pengambilan Contoh dari Balai/Laboratorium Uji:

Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Bandung

Nomor : 504 / Bd / BBBBT-3 / III / 2011

Tanggal : 2 Maret 2011

dengan disaksikan oleh pihak Perusahaan:

Nama : IVO. AGUSTIAN

Jabatan : PRD - GROUP LEADER



telah melakukan pengambilan contoh:

- No. SNI : 16-2626-1992
- Judul SNI : Tempat Tidur Baja Beroda
- Tipe/jenis Produk : 1 alas pengantar < CB-135 D >
- Merek Produk : CHITOSE
- Nama Perusahaan : PT. CHITOSE INDONESIA MFG. LTD
- Alamat Kantor : Jl. Industri III No.5 Leuwi Gajah - Cimahi
- Alamat Pabrik : Jl. Industri III No.5 Leuwi Gajah - Cimahi
- Dengan Tanda/Kode Nomor : CBD - 1 ; CBD - 2 ; CBD - 3
- Sebanyak : 3 <tiga>
- Mewakili jumlah Produk
sebesar : 100
- Dari seri Produksi yang
dikeluarkan tanggal : 1 Februari - 28 Februari
- Dengan cara pengambilan
contoh : Acak

Kemudian contoh tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yang sama, dikemas, diberi Label
 Contoh Uji dan dikirimkan kepada masing-masing 1 (satu) bagian contoh kepada
 Perusahaan (sebagai arsip) dan 1 (satu) bagian contoh kepada Balai/Laboratorium Uji.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Contoh ini dibuat dengan sesungguhnya.

Saksi-saksi :

1. Shanty M 
2. Yani 

Petugas Pengambil Contoh,



Eduard Lodewik K



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

PUSAT STANDARDISASI

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN R.I.

SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI



LABEL CONTOH UJI

No. SNI	: 16-2625-1992
Judul SNI	: Tempat Tidur Baja Beroda untuk Rumah Sakit dengan pengatur posisi tidur
Tipe/Jenis Produk	: 1 aks pengatur (CB-135 D)
Merek Produk	: CHITOSE
Jumlah	: 3 (tiga)
No. Contoh	: CBD 1
Tgl. Pengambilan Contoh	: 3 Maret 2011
No. BAPC	: 570.2 / Bd / BBBBT-3 / III / 2011
Nama Perusahaan	: PT CHITOSE INDONESIA MFG. LTD.
Alamat Pabrik	: Jl. Industri III No.5 Leuwi Gajah - Cimahi
No. dan Tgl. Surat Tugas	: 584 / Bd / BBBBT-3 / III / 2011
Nama Petugas	: Eduard Lodewik K

CAP DAN TANDA TANGAN
PENGUSAHATANDA TANGAN
PETUGAS



LAPORAN PENGUJIAN

Test Report

NO. LAPORAN : 9-29-11-0064
Report No.

KOMODITI : TEMPAT TIDUR BAJA
Commodity

DIBUAT UNTUK : PT. CHITOSE INDONESIA MFG
Executed for
Jl. Industri III No.5 Leuwigajah - Cimahi

DITERIMA TANGGAL : 06 Maret 2011
Received Date

URAIAN CONTOH : Telah diterima 1 (satu) contoh tempat tidur baja beroda untuk rumah sakit dengan
Detail of Sample pengatur posisi tidur, dengan data sebagai berikut:
a. nama pabrik : PT.CHITOSE INDONESIA MFG.LTD
b. merek : CHITOSE
c. tipe / model : CB-135 D
d. kode contoh : CBD

Contoh tempat tidur baja beroda untuk rumah sakit tersebut di atas telah dilakukan pengujian dalam rangka pengawasan/penggunaan sertifikat tanda SNI 16-2626-1992. Pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) berdasarkan surat tugas pengambilan contoh no. 584/Bd/BBBT-3/III/2011, tanggal 2 Februari 2011 dan berita acara pengambilan contoh no. 570.2/Bd/BBBT-3/III/2011, tanggal 3 Maret 2011.

TANGGAL PENGUJIAN : 16 Maret 2011 – 11 Mei 2011
Tested Date

STANDAR ACUAN/METODA : SNI 16-2626-1992
UJI
Test Method / Reference Standard

STANDAR/METODE : -
PENGAMBILAN CONTOH
Sampling Standard/Method

HASIL PENGUJIAN : Terlampir
Test Result (Attached)

DITERBITKAN TANGGAL : 11 Mei 2011
Issued Date

PERHATIAN : 1. Laboratorium ini diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) No. LP-007-1DN.
NOTE This laboratory is accredited by the National Accreditation Committee (KAN) No. LP-007-1DN.
2. Laporan ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara Keseluruhan.
This report shall not be reproduced except in full.



Laporan No. : 9-29-11-0064

Tanggal : 11 Mei 2011


Halaman: 2 dari 4

Komoditi : Tempat Tidur Baja Beroda untuk rumah sakit dengan pengatur posisi tidur

HASIL PENGUJIAN

No.	JENIS UJI	SATUAN	HASIL UJI	SYARAT SNI 16-2625-1992
1.	Syarat mutu .			
1.1	Bahan baja lembaran :			SNI 07-0601-2006
	a. tebal	mm	0,82 – 2,84	0,8 – 2,0
	b. kuat tarik	kgf/mm	32,9	min. 30
	c. regang putus	%	46,8	min. 30
	d. komposisi kimia (% berat):			
	- Karbon	%	0,04245	maks. 0,15
	- Mangan	%	0,22602	maks. 0,35
	- Posfor	%	0,01461	maks. 0,60
	- Sulfur	%	0,01489	maks. 0,03
1.2	Bahan pipa :			SNI 07-0068-1987
	a. diameter luar □ 50mm x 30mm	mm	50,1 x 30,0	
	b. tebal	mm	1,81 – 2,01	
	c. kuat tarik	kgf/mm	39,7	min. 30
	d. regang putus	%	37,8	min. 30
	e. komposisi kimia (% berat):			
	- Karbon	%	0,04245	maks. 0,12
	- Silika	%	0,0043	maks. 0,35
	- Mangan	%	0,22802	maks. 0,60
	- Posfor	%	0,01461	maks. 0,04
	- Sulfur	%	0,01489	maks. 0,04
1.3	Ketahanan roda	–	Tahan pada rintangan setinggi 15 mm pada kemiringan 15 ° sebanyak 7000 kali	harus tahan pada rintangan setinggi 15 mm pada kemiringan 15 ° sebanyak 7000 kali
2.	Konstruksi			
2.1	Bentuk dan ukuran:			SNI 07-0410-1989
	- panjang (p)	mm	2003	2000 ± 5
	- lebar (l)	mm	910	935 ± 5
	- lebar atas (la)	mm	830	900 ± 5
	- tinggi tempat tidur (t)	mm	582	670 ± 5
	- tinggi keseluruhan bagian kepala (tp)	mm	1245	1150 ± 5
	- tinggi keseluruhan bagian kaki (th)	mm	775	980 ± 5
	- diameter roda (d)	mm	100,1	min. 100
2.2	Fabrikasi :	–	Sesuai norma pengelasan	harus sesuai norma pengelasan.
	a. Cara pengelasan sesuai dengan norma / aturan.			
	b. Kemudahan tempat tidur dibongkar dan dipasang kembali	–	Mudah dibongkar dan dipasang kembali	harus mudah dibongkar dan dipasang kembali.

PERHATIAN : 1. Laboratorium ini diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) No. LP-007-IDN.
 This laboratory is accredited by the National Accreditation Committee (KAN) No. LP-007-IDN.
 2. Laporan ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara keseluruhan.
 This report shall not be reproduced except in full.

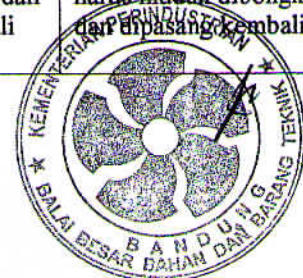



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA
Telp. 022 – 2504088, 2510682, 2504828 Fax. 022 – 2502027
Website : www.b4t.go.id E-mail : b4t@bdg.centrin.net.id



Laporan No. : 9-29-11-0064

Tanggal : 11 Mei 2011


Halaman: 3 dari 4

Komoditi : Tempat Tidur Baja Beroda untuk rumah sakit dengan pengatur posisi tidur

HASIL PENGUJIAN

No.	JENIS UJI	SATUAN	HASIL UJI	SYARAT SNI 16-2625-1992
	c. Kekuatan dan kokokohan tempat tidur yang tidak mudah goyang dan besudut siku	-	Kuat, kokoh, siku dan tidak goyang	harus kuat, kokoh, siku, dan tidak goyang.
	d. Tersedia lubang ventilasi yang berfungsi untuk pendinginan : - persentase luas lubang - ukuran lubang - jarak lubang dari tepi	- % mm mm	Ada 29 45 x 350 80	harus ada - - min. 80
	e. Jumlah pipa pembatas bagian kaki dan kepala.	buah	5	min. 5
	f. Perakitan roda yang dilakukan dengan skrup harus dilengkapi rem dan dipasang secara silang.	-	Dilengkapi rem dan dipasang secara silang	harus dilengkapi rem dan dipasang secara silang.
	g. Defleksi maksimum alat pengatur - sebelah kanan - sebelah kiri	-	77° 62°	min. 75° min. 60°
	h. Perakitan roda yang dilakukan dengan skrup harus dilengkapi rem dan dipasang secara silang.	-	Dilengkapi rem dan dipasang secara silang	harus dilengkapi rem dan dipasang secara silang.
	i. Roda mampu berputar 360°	-	Dapat berputar 360°	harus dapat berputar 360°
3.	Syarat mutu			
3.1	Sifat tampak	-	Bebas dari cacat, lekukan, ketidak seragaman pengecatan, dan bagian tajam	harus bebas dari cacat, lekukan, ketidak seragaman pengecatan, dan bagian tajam
3.2	Uji unjuk kerja			
3.2.1	Uji ketahanan terhadap pembebanan 180 kg secara kontinu selama 24 jam.			
	a. Saat pembebanan.			
	a.1 Posisi alas tempat tidur datar (pada sudut 0°), pengukuran defleksi pada :			
	- rangka	mm	0,16	maks. 0,2
	- kepala	mm	0,12	maks. 0,2
	- kaki	mm	0,14	maks. 0,2

PERHATIAN : 1. Laboratorium ini diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) No. LP-007-IDN.
This laboratory is accredited by the National Accreditation Committee (KAN) No. LP-007-IDN.
2. Laporan ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara keseluruhan.
This report shall not be reproduced except in full.
NOTE

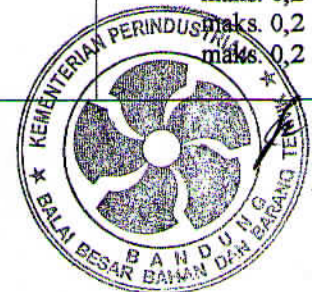



Laporan No. : 9-29-11-0064

Tanggal : 11 Mei 2011

Halaman: 4 dari 4

Komoditi

: Tempat Tidur Baja Beroda untuk rumah sakit dengan pengatur posisi tidur

HASIL PENGUJIAN

No.	JENIS UJI	SATUAN	HASIL UJI	SYARAT SNI 16-2625-1992
	a.2 Posisi alas tempat tidur sudut 30°, pengukuran defleksi saat pembe-banan pada : - rangka - kepala - kaki	mm mm mm	0,17 1,42 0,82	maks. 0,2 maks. 10 maks. 10
	b. Setelah beban diambil b.1 Posisi alas tempat tidur datar (pada sudut 0°), pengukuran defleksi setelah pembebanan : - rangka - kepala - kaki	mm mm mm	0 0 0	maks. 0 maks. 0 maks. 0
	b.2 Posisi alas tempat tidur sudut 30°, pengukuran defleksi setelah pembebanan pada : - rangka - kepala - kaki		0 0 0	maks. 0 maks. 6 maks. 5
4.	Uji ketahanan kelancaran roda pada rintangan setinggi 15 mm pada kemiringan 15° sebanyak 7000 kali	-	Tidak terjadi deformasi dan gangguan kelancaran roda	harus tidak terjadi deformasi dan gangguan kelancaran gerakan roda
5.	Ketahanan alat pengatur posisi tidur	-	Tidak rusak setelah dioperasikan dengan membentuk posisi sudut 0° sampai 30° sebanyak 7000 kali	harus tidak rusak setelah dioperasikan dengan membentuk posisi sudut 0° sampai 30° sebanyak 7000 kali
6.	Pengecatan a. Kelekatan b. Ketebalan lapisan cat	- mikron	Tidak mengelupas 76,9	harus tidak mengelupas min. 20
7.	Tahanan listrik roda	Ω	>10000 Ω dengan arus 41 A	min. 10.000

PERHATIAN : 1. Laboratorium ini diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) No. LP-007-IDN.
This laboratory is accredited by the National Accreditation Committee (KAN) No. LP-007-IDN.
NOTE 2. Laporan ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara keseluruhan.
This report shall not be reproduced except in full.

